



CONTIPHARMA

a member of Bedelco group

COVID19

CATALOGUE 2021





Kit de Test Antigène SARS-CoV-2

Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay



Composants	Quantité	Contenu	Poids	Dimension (mm)
Carte de test	25 packs	Carte de test x 25 pcs Déshydratant x 25 pcs		
Tube d'extraction	1 pack	Tube d'extraction x 25 pcs		
Bouchon	2 packs	bouchon x 25 pcs	300g	200x115x80
Ecouvillon	25 packs	Ecouvillon Naso-pharyngé x 25 pcs		
Tampon d'extraction	1 bouteille	Tampon d'extraction x 8ml		
Mode d'emploi	1 copie	1 copie		

NOM DU PRODUIT

Kit de test de l'antigène du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2(SARS-CoV-2) (test immunologique chromatographique à l'or colloïdal)

SPÉCIFICATION

Réf. Non.	Montant	Cassette de test	Écouvillon	Tampon d'extraction	Tube d'extraction
SC0232	1 T/Kit	1 pièce	1 pièce	1 x 0,4mL/flacon	1 pièce
SC0233	2 T/Kit	2 pièces	2 pièces	2 x 0,4mL/flacon	2 pièces
SC0234	5 T/Kit	5 pièces	5 pièces	5 x 0,4mL/flacon	5 pièces

UTILISATION PRÉVUE

Le kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 est un système de test immunochromatographique pour la détection rapide et qualitative de l'antigène du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) dans des échantillons d'écouvillonnage nasal humain. Il peut être utilisé pour le diagnostic de la maladie d'infection à coronavirus (COVID-19) in vitro, qui est causée par le SRAS-CoV-2.

Le kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 fournit des résultats préliminaires. Des résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SRAS-CoV-2. Il ne peut pas être utilisé comme seule base pour un traitement ou toute autre décision de gestion. Le test offre aux personnes la possibilité de réaliser elles-mêmes l'écouvillonnage nasal sous la supervision d'un médecin spécialiste.

PRINCIPE

Le kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 est basé sur la méthode d'immunochromatographie à l'or colloïdal pour détecter la protéine N du SRAS-CoV-2 dans les sécrétions respiratoires et autres échantillons. Lorsque l'échantillon est ajouté dans le dispositif de test, il est absorbé par l'action capillaire, se mélange avec l'anticorps marqué à l'or et traverse la membrane pré-enduite.

L'antigène SARS-CoV-2 de l'échantillon capturé par l'anticorps S1a marqué à l'or se lie à l'anticorps S1 immobilisé dans la zone de test (T) de la membrane, ce qui produit une bande de test colorée qui indique un résultat positif.

Lorsqu'il n'y a pas d'antigène SARS-CoV-2 dans l'échantillon ou que la concentration est inférieure à la limite de détection du test, il n'y a pas de bande colorée visible dans la zone de test (T) de l'appareil. Cela indique un résultat négatif.

Pour servir de contrôle de procédure, une ligne colorée apparaîtra au niveau de la région de contrôle (C), si le test a été effectué correctement.

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

Minuterie

Équipement de protection individuelle, tel que gants de protection, masque médical, lunettes de protection et blouse de laboratoire.

Conteneur pour déchets à risques biologiques et désinfectants appropriés.

ÉTAT DE CONSERVATION

La carte de test est stable pendant 12 mois (lorsqu'elle est scellée dans un sac en aluminium) si elle est stockée à 2-30°C. Lorsque l'humidité de l'environnement de test est supérieure à 60 %, la carte de test doit être utilisée immédiatement après l'ouverture du sac en aluminium. Lorsque l'humidité ambiante est inférieure à 60 %, la carte de test doit être utilisée dans l'heure qui suit l'ouverture du sachet en aluminium.

COLLECTE ET PRÉPARATION DES SPÉCIMENS

Collecte de spécimens :

1. Il est applicable au diagnostic du Novel coronavirus à partir d'échantillons d'écouillons nasaux. Utilisez des échantillons fraîchement prélevés pour une performance optimale du test. Un prélèvement inadéquat ou une manipulation incorrecte de l'échantillon peut donner un résultat faux-négatif.
2. Pour le prélèvement d'écouillons nasaux, insérez l'écouillon dans une narine du patient. L'extrémité de l'écouillon doit être insérée à une profondeur de 2 à 4 cm, jusqu'à ce que l'on sente une résistance. Faites ensuite rouler l'écouillon 5 fois sur la muqueuse à l'intérieur de la narine pour vous assurer que le mucus et les cellules sont recueillis. Répétez cette étape avec le même coton-tige dans l'autre narine afin de recueillir un échantillon suffisant dans les deux narines. Retirez enfin l'écouillon de la cavité nasale.



EXIGENCES RELATIVES AUX SPÉCIMENS

1. Retirer le bouchon d'un tampon d'extraction, ajouter tout le tampon d'extraction dans le tube d'extraction.
2. Placez l'échantillon de l'écouillon du patient dans le tube d'extraction. Faites rouler la tête de l'écouillon contre l'intérieur du tube d'extraction au moins 3 fois, puis attendez 1 minute.
3. Retirez l'écouillon en pressant la tête de l'écouillon contre l'intérieur du tube pour expulser le plus de liquide possible de l'écouillon. Jetez l'écouillon usagé avec vos déchets biologiques.
4. Pressez fermement le capuchon de la buse sur le tube.

Les échantillons extraits peuvent être conservés pendant 1 heure maximum à température ambiante et pendant 4 heures maximum à une température comprise entre 2 et 8 °C.


PROCÉDURE DE TEST

1. Sortez la carte de test du sac en aluminium et posez-la à plat sur le banc d'essai.
2. Ajoutez 3 gouttes (environ 80µl) de l'échantillon extrait dans le puits d'échantillon du dispositif de test.
3. Lisez les résultats dans les 15 minutes.

NOTE : L'expérience doit être faite à 15~30.humidité 35%~85%.

L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

1. La présence de deux lignes (Test et Contrôle), quelle que soit l'intensité de la ligne de test, indique un résultat positif.
2. Une seule ligne de contrôle indique un résultat négatif.
3. Si la ligne de contrôle n'apparaît pas, les résultats ne sont pas valides et le test doit être répété.

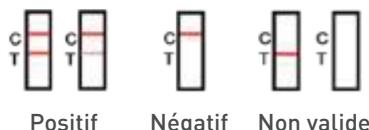

INSTRUCTIONS POUR L'ACTION EN FONCTION DU RÉSULTAT DU TEST

1. En cas de résultat positif du test :
 - Il y a actuellement une suspicion d'infection par le COVID-19.
 - Contactez immédiatement un médecin/médecin de famille ou les autorités sanitaires locales.
 - Respecter les directives locales en matière d'auto-isolation
 - de faire effectuer un test de confirmation par PCR
2. En cas de résultat négatif du test :
 - Continuez à respecter toutes les règles applicables concernant le contact avec les autres et les mesures de protection.
 - Une infection peut être présente même si le test est négatif.
 - En cas de suspicion, répétez le test après 1 à 2 jours, car le coronavirus ne peut être détecté avec précision dans toutes les phases d'une infection.
3. En cas de résultat de test invalide :
 - Possiblement causé par une mauvaise exécution des tests
 - Répétez le test
 - Si les résultats du test restent invalides, contactez un médecin ou le centre de test COVID 19.

LIMITATION DE LA MÉTHODOLOGIE

1. Le kit de test de l'antigène du nouveau SRAS-CoV-2 est un test de dépistage en phase aiguë pour une détection qualitative. L'échantillon prélevé peut contenir une concentration d'antigène inférieure au seuil de sensibilité du réactif. Un résultat négatif n'exclut donc pas une infection par le nouveau coronavirus.
2. Le kit de test Novel SARS-CoV-2 Antigen détecte les antigènes viables et non viables du nouveau coronavirus. La performance du test dépend de la charge antigénique de l'échantillon et peut ne pas être corrélée avec la culture cellulaire réalisée sur le même échantillon. Un test positif n'exclut pas la possibilité que d'autres agents pathogènes soient présents. Par conséquent, les résultats doivent être comparés à toutes les autres informations cliniques et de laboratoire disponibles pour établir un diagnostic précis.
3. Un résultat négatif peut être obtenu si le niveau d'antigène extrait dans un échantillon est inférieur à la sensibilité du test ou si un échantillon de mauvaise qualité est obtenu.
4. La performance du test n'a pas été établie pour le suivi du traitement antiviral du nouveau coronavirus.

5. Un test positif n'exclut pas la possibilité de co-infections avec d'autres agents pathogènes.
6. Un résultat négatif ne permet pas d'exclure une autre infection à coronavirus que le SARS-CoV-2.
7. Les enfants ont tendance à excréter le virus pendant de plus longues périodes que les adultes, ce qui peut entraîner des différences de sensibilité entre les adultes et les enfants List.
8. Un résultat négatif peut survenir si la concentration d'antigène dans un échantillon est inférieure à la limite de détection du test ou si l'échantillon a été collecté ou transporté de manière incorrecte. Par conséquent, un résultat négatif n'élimine pas la possibilité d'une infection par le SRAS-CoV-2 et doit être confirmé par une culture virale ou une PCR.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

1. SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ

Les échantillons d'écouillons nasaux de 226 patients, dont 107 résultats positifs et 119 résultats négatifs ont été confirmés par le jugement du diagnostic clinique. Le résultat de l'évaluation clinique du kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 était le suivant :

Méthode		PCR		SOMME
SRAS-CoV-2 Kit de test antigénique	Résultat	Positif	Négatif	
	Positif	102	1	103
	Négatif	5	118	123
SOMME		107	119	226
Sensibilité		95,33% (95%CI:91,31%~96,20%)		
Spécificité		99,16% (95%CI:95,39%~99,85%)		
Précision		97,35% (95%CI:95,37%~97,74%)		

2. LIMITÉ DE DÉTECTION (LoD)

2019-nCoV Concentration	1 X 10 ⁶ TCID ₅₀ /mL					
Dilution	1/100	1/200	1/400	1/800	1/1600	1/3200
Concentration dans la dilution testée (TCID ₅₀ /mL)	1X10 ⁴	5X10 ³	2.5X 10 ³	1.25X10 ³	6.25X10 ²	3.125X10 ²
Taux de 20 répétitions (%)	100(20/20)	100(20/20)	100(20/20)	100(20/20)	100(20/20)	10(2/20)
Limite de détection	6.25X10 ² TCID ₅₀ /mL					

3. EXPÉRIENCE D'INTERFÉRENCE

Les substances suivantes ont été testées à la concentration indiquée, et aucune interférence n'a été trouvée.

Mucine	100µg/mL	Acide acétylsalicylique	3,0 mM
Sang total	5% (v/v)	Ibuprofène	2,5 mM
Biotine	100µg/mL	Mupirocine	10 mg/mL
Néo-Synéphrine (Phényléphrine)	5%(v/v)	Tobramycine	10µg/mL
Afrin Spray nasal (Oxymétaزoline)	5%(v/v)	Erythromycine	50uM
Spray nasal salin	5%(v/v)	Ciprofloxacine	50uM
Homéopathie	5%(v/v)	Ceftriaxone	110mg/mL
Cromoglycate de sodium	10 mg/mL	Meropenem	3,7µg/mL
Chlorhydrate d'olopatadine	10 mg/mL	Tobramycine	100µg/mL
Zanamivir	5 mg/mL	Histamine	100µg/mL
Oseltamivir	Chlorhydrate	100µg/mL	1mmol/mL
Artéméther-luméfantrine	10 mg/mL	Peramivir	100µg/mL
Doxycycline hyclate	50uM	Flunisolide	0,64nmol/ L
Quinine	50uM	Budesonide	0,3ng/mL
Lamivudine	150uM	Fluticasone	6µg/mL
Ribavirine	1 mg/mL	Lopinavir	8,2mg/mL
Daclatasvir	1 mg/mL	Ritonavir	417.8ng/mL
Acétaminophène	1 mg/mL	Abidor	N/A

4. RÉACTIVITÉ CROISÉE

Virus/Bactérie/ Parasite	Souche	Source/type de spéécimen	Concentration	Résultat
SRAS-coronavirus	N/A	SINO/protéine recombinante	25ug/mL	Négatif
MERS-coronavirus	N/A		72 ug/mL	Négatif
Adénovirus	Type 1	AMMS Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 3		7,5E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 5		4,5E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 7		1,0E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 8		1,0E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 11		2,5E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 18		2,5E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 23		6,0E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 55		1,5E+06TCID ₅₀ /mL	Négatif
Influenza A	H1N1 Denver	AMMS / Virus de culture inactivé	3,0E+08TCID ₅₀ /mL	Négatif
	H1N1 WS/33		2,0E+08TCID ₅₀ /mL	Négatif
	H1N1 A/Mal/302/54		1,5E+08TCID ₅₀ /mL	Négatif
	H1N1 Nouvelle-Calédonie		7,6E+08TCID ₅₀ /mL	Négatif
	H3N2 A/ Hong Kong/8/68		4,6E+08TCID ₅₀ /mL	Négatif

Virus/Bactérie/ Parasite	Souche	Source/type de spécimen	Concentration	Résultat
Influenza B	Nevada/03/2011	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+08 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	B/Lee/40		8,5E+08 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	B/Taiwan/2/62		4,0E+08 TCID ₅₀ /mL	Négatif
Virus respiratoire syncytial	N/A	AMMS / Virus de culture inactivé	2,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
Legionella pneumophila	Bloomington-2	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	Los Angeles-1		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	82A3105		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
Mycobacterium tuberculosis	K	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	Erdman		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	HN878		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	CDC1551		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	H37Rv		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
Streptococcus pneumonia	4752-98 [Maryland (D1)6B-17]	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	178 [Pologne 23F-16]		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	262 [CIP 104340]		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	Slovaquie 14-10 [29055]		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
Streptococcus pyrogènes	Souche de typage T1 [NCIB 11841, SF 130]	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
Mycoplasma pneumoniae	Mutant 22	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	Souche FH de l'agent E aton [NCTC10119]		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
	36M129-B7		1×10 ⁵ PFU/mL	Négatif
Coronavirus	229E	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	OC43		1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	NL63		1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	HKU1		1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
Etapneumovirus humain (hMPV) 3 Type B1	Pérou2-2002	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
Métapneumovirus humain	IA10-2003	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
(hMPV) 16 Type A1	Type 1	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 2		1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 3		1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
	Type 4A		1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif
RhinoVIRUS A16	N/A	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06 TCID ₅₀ /mL	Négatif

ATTENTION

1. Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.
2. Une collecte, un stockage et un transport appropriés des échantillons sont essentiels à la réalisation de ce test.
3. A n'utiliser qu'une seule fois.
4. Ne pas toucher la zone de réaction de la bande de test.
5. N'utilisez pas le kit de test au-delà de la date d'expiration.
6. N'utilisez pas le kit si la pochette est percée ou mal fermée.
7. Après utilisation, jetez les cartes de test et les articles en contact avec les échantillons comme des déchets médicaux.
8. Ne pas congeler.

INTERPRÉTATION DES ICÔNES

	Ne pas réutiliser		Limite de température
	Dispositif médical de diagnostic in vitro		Code du lot
	Contient des éléments suffisants pour <n>test		Consultez le mode d'emploi
	Fabricant		Date de fabrication
	Marque CE		Date limite d'utilisation
	Garder au sec		Par ici, en haut
	Fragile, à manipuler avec précaution		Limite des couches d'empilage
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec. Co., Ltd.



Room 701, No.71-3, Xintian Avenue, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, P. R. China 518103

Tél : +86-755-82599902

Fax : +86-755-82599221



CMC Dispositifs médicaux et médicaments S.L.

C/ Horacio Lengo N°18, CP 29006, Málaga, Espagne

Tél : +34951214054

Mail:info@cmcmedicaldevices.com

Date d'émission : 24/03/2021



Masques FFP2 / KN95



EXTERIEUR



INTERIEUR

MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 95%



SPÉCIFICATIONS

Masque 5 couches :

- Première couche : 60g/m² en tissu non tissé
- Seconde et troisième couche : 30g/m² en tissu non tissé haute efficacité, soufflé par fusion
- Quatrième couche : 50g/m² coton à air chaud
- Cinquième couche : 25g/m² en tissu non tissé

Composition :

Non-tissés liés par filage, non-tissés soufflés par fusion, coton à air chaud, pince-nez, boucles d'oreille

Performance du produit :

Ajustement parfait pour chaque visage et protection optimale. Convient pour la protection de certaines particules non huileuses, telles que le virus de la grippe, la poussière, le pollen, etc.

Temps de port recommandé :

4-8 heures, à changer entre deux actes médicaux. Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.

APPLICATION

Écoles, trains à grande vitesse, aéroports, transports publics et autres lieux relativement densément peuplés et environnement familial.

CONFORMITÉ

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE

Norme 149:2001 + A1:2009 / GB2626-2006 KN95 en lien avec le règlement CE R2016/425 (Personal Protective Equipment)



CONDITIONNEMENT

5 pcs / paquet, 4 paquets / boîte., 48 btes / carton, 960 pièces / carton,
Dimensions du carton : 57,5 x 33,5 x 38 cm – 8,35 kg

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et propre, à l'écart du feu, entre -20 et 38 ° C avec une humidité relative inférieure à 30%.

DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans



Masques respiratoire FFP3 Purism



MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 95% (testé selon les normes GB2626-2019)

TAILLE

13,8x11x5x5,2 cm

SPÉCIFICATIONS

Masque 5 couches :

- tissu non tissé en PP
- tissu soufflé par fusion en PP
- tissu non tissé par air
- pince-nez en aluminium
- serre tête en nylon/polyuréthane composite



APPLICATION

Les respirateurs à particules Purism FFP3 offrent une protection respiratoire efficace pour une utilisation dans les industries où les travailleurs seront exposés à des particules solides (poussières) et / ou des particules liquides non volatiles. Idéal pour les applications où un facteur de protection plus élevé est requis, offrant une protection contre la plupart des gaz, vapeurs et particules.

CONFORMITÉ

Marquage CE 2016/425
Norme EN 149/2001+a1/2009

CONDITIONNEMENT



20 pces / boîte., 20 boîtes / carton, 400 pièces / carton,
Dimensions du carton : 67 x 28 x 36 cm – 11,7 kg

STOCKAGE

à stocker dans un endroit gazeux sec, propre, ventilé et non corrosif, loin de sources d'ignition ou de matériaux combustibles

DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans

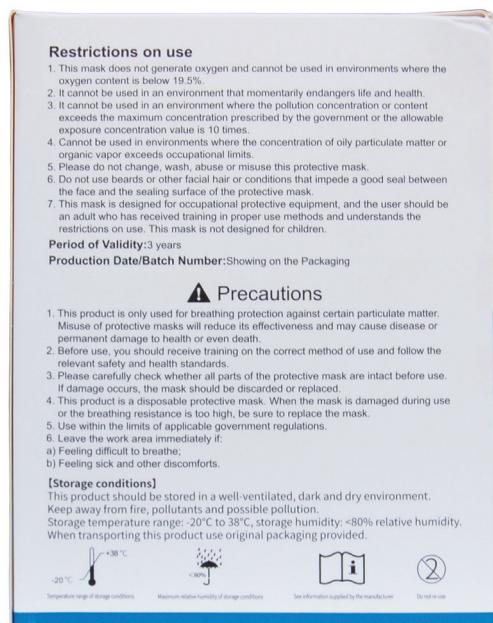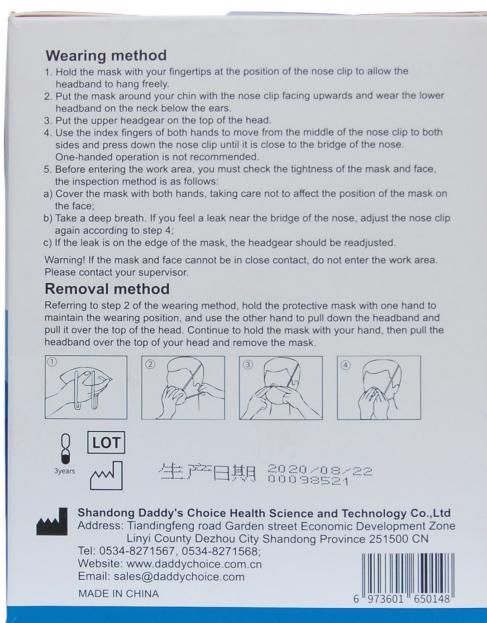



Masques Chirurgicaux Purism Type IIR



EXTERIEUR

INTERIEUR

MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 99%



SPÉCIFICATIONS

Masque 3 couches :

- Première couche : tissu non-tissé étanche (nouveau tissu non-tissé) : inhibe et isole efficacement les particules et les gaz nocifs
- Seconde couche : couche filtrante haute densité (tissu non-tissé soufflé)
- Troisième couche : couche en contact direct avec la peau, en nouveau tissu non-tissé, résistant à l'humidité, permettant une respiration aisée, non toxique, non stimulant, doux et respectueux de la peau

Composition :

Tissu non tissé filé-lié, tissu non tissé soufflé par fusion, boucles d'oreille et barre de pont nasal

Temps de port recommandé :

4-8 heures, à changer entre deux actes médicaux. Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.

APPLICATION

pour le personnel médical pendant les opérations. Il recouvre la bouche, le nez et la mâchoire de l'utilisateur, fournissant une barrière physique pour empêcher le passage direct d'agents pathogènes, de micro-organismes, de fluides corporels et de particules. Ne pas utiliser dans un environnement traumatique.

CONFORMITÉ

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE
Norme EN 14683 Type IIR.



CONDITIONNEMENT

10 pcs / sachet, 5 sachets / boîte., 48 btes / carton, 2400 pièces / carton,
Dimensions du carton : 47,5 x 41,5 x 56 cm – 11,7 kg

STOCKAGE

à stocker dans un endroit gazeux sec, propre, ventilé et non corrosif, loin de sources d'ignition ou de matériaux combustibles.

DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans





Charlotte Clip bleue/blanche


Ref 10001



Serrage élastique souple, sans pression
Très léger, agréable à porter
Zéro entretien (usage unique)

SPÉCIFICATIONS

- Modèle rond avec **double élastique**
- Couleur : bleue/blanche
- Usage unique
- En polypropylène non tissé
- Poids : 12 g/m²
- Conditionnement : sachet de 100 pièces

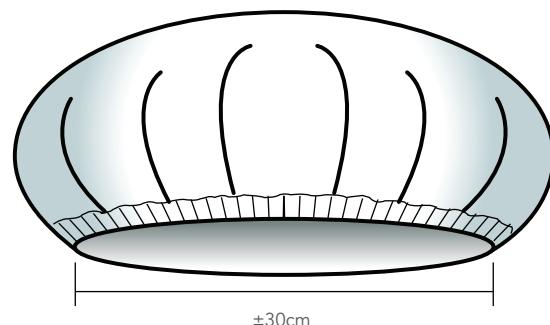



APPLICATION

Utilisation : Ces charlottes peuvent être utilisées lors de nombreux travaux nécessitant de vous protéger contre de légères salissures et/ou de protéger l'environnement contre les particules et micro-poussières émises par l'utilisateur. Industrie pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, d'entretien, hôpitaux, entretien ménager, industries agroalimentaire, fromageries, laiteries, visites d'usines, conditionnement et emballage...

Article de propreté : Ce produit n'est pas un équipement de protection individuel mais un article de propreté; ne pas utiliser contre des dangers susceptibles de menacer la santé ou la sécurité de l'utilisateur. Lors des activités dans certains milieux sensibles comme l'alimentaire, l'électronique, il est généralement obligatoire de retirer tout objet personnel décoratif : bagues, colliers, bracelets...



Cagoule avec masque intégré

Ref 10002



SPÉCIFICATIONS

Cagoule polypropylène avec masque type II intégré

La cagoule en polypropylène 25 g intègre un masque 3 couches avec une bonne capacité de filtration (type II). Sa perméabilité à l'air assure un grand confort.

Elle est particulièrement adaptée pour les entreprises alimentaires et les abattoirs où un masque médical est obligatoire. Une barrette nasale malléable assure une adaptation individuelle au visage et les élastiques sans latex permettent également aux personnes allergiques d'utiliser le produit.



Surblouse 35g

Ref 30001



SPÉCIFICATIONS

- Blouse polypropylène Bleue/Blanche/Verte jetable, pour tout type d'usage et une protection efficace
- 35g/m^2
- Fermeture à cordon – attache derrière
- Perméable à l'air
- Peu absorbant
- Convient pour les milieux médicaux, agroalimentaires, restauration collative, industries
- Taille unique
- Tour de poitrine : 690 mm x 2
- Longueur de la manche depuis le col : 780 mm
- Largeur de la manche : 250 mm
- Longueur totale : 1050 mm
- Conditionnement : carton de 100 pcs





Tablier 35g blanc TU

Ref 30002



SPÉCIFICATIONS

- Blouse jetable en polypropylène pour tout type d'usage et protection efficace
- 35 g/m²
- col cousu
- fermeture velcro – à l'avant
- avec poches
- perméable à l'air
- peu absorbant
- Convient pour les milieux médicaux, agroalimentaires, restauration collective, industrie
- taille unique
- tour de poitrine : 690 mm x 2
- Longueur de la manche depuis le col : 780 mm
- Largeur de la manche : 250 mm
- Longueur totale : 1050 mm
- Conditionnement : carton de 100 pcs





Surblouse PLP gr

Ref 30004



SPÉCIFICATIONS

- Couleur : blanche / bleue
- Polypropylène 25 gr
- Resserrée par élastique aux poignets
- Attache derrière par cordon
- Taille unique





Tablier velcro 25g

Ref 30006



SPÉCIFICATIONS

- Tablier avec attache devant par velcro
- Couleur : blanche
- Polypropylène 25 g
- Avec col
- Poignets resserrés par élastique
- Taille : M / L / XL





Combinaison d'isolation

Ref 30007



Combinaison en polypropylène/polyéthylène blanche avec des bandes bleues, 65 gr, jetable, avec capuche et élastique à la taille aux poignets et aux chevilles.

Taille : L - XL - XXL

Ces combinaisons offrent une solution de vêtement efficace et peu coûteux qui protège contre les particules sèches comme la saleté et la poussière sur le lieu de travail. Ils sont légers, confortables, la peau peut respirer et ils peuvent être utilisés dans des milieux tels que les hôpitaux, les usines de transformation des aliments et les applications industrielles générales.

Facile à endosser, antipoussière, antibactérien, antivirus

Certificats : sur demande





Surchaussure

Ref 40001



SPÉCIFICATIONS

- Surchaussure antidérapante en propylène non tissé, non stérile
- Elastique de serrage aux chevilles pour un maintien parfait
- Semelle gaufrée antidérapante, renforcée et imperméable
- Couleur : blanc avec semelle bleue
- Dimensions : 16,5 x 41,5 cm
- Grammage : 30g/m²

Nos surchaussures assurent une barrière efficace contre les bactéries et les virus.

Le port de ces protections réduit aussi les risques d'accident au travail.

Leurs avantages :

- Garantir la propreté des locaux pour une hygiène optimale ;
- Eviter les contaminations extérieures ;
- Protéger les chaussures des éclaboussures ou des projections salissantes ;
- Réduire les risques d'accident au travail ;
- Protéger les salariés et les visiteurs de passage.



APPLICATION

- Industries agroalimentaires
- Secteur de la microélectronique
- Filières automobiles
- Industrie spatiale
- Hôpitaux et établissements de santé



Gants nitrile « Purism » G001

Ref 50001



SPÉCIFICATIONS

Les gants d'examen « Purism » G001 conviennent aux environnements de travail où il y a contact possible avec des fluides corporels, des micro-organismes et des produits chimiques. Ils ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel et constituent une excellente alternative pour les personnes souffrant d'allergies de type I.

Ce sont des gants non poudrés qui offrent une grande souplesse, un toucher de grande sensibilité et une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont résistants aux déchirures, ambidextres et non stériles.

TAILLES

Taille	Longueur minimale (mm)	Largeur de paume (mm)	Poids (g)	Epaisseur minimum (mm)
XS	240	≤ 80	3.8 ± 0.2	0,05
S	240	80 ± 10	4.3 ± 0.2	0,05
M	240	95 ± 10	4.8 ± 0.2	0,05
L	240	110 ± 10	5.3 ± 0.2	0,05
XL	240	≥ 110	5.8 ± 0.2	0,05

NORME

EN455



PRINCIPALES MATERIES PREMIERES

- Caoutchouc nitrile butadiène ≥90%
- Oxyde de zinc 4%
- Dioxyde de titane 2,6%

UTILISATION

Domaine médical, industries alimentaires, industries chimiques,...

REMARQUES

- Les gants d'examen sont des produits à usage unique et ne doivent être utilisés que pour une seule procédure et/ou un seul patient
- Lorsque vous portez des gants, ne portez pas de bagues ou autres ornements et coupez les ongles en douceur
- Portez-les indifféremment sur la main gauche ou droite, veuillez choisir des gants adaptés aux spécifications de votre main
- Ne pas utiliser si les gants sont contaminés en raison d'un emballage défectueux
- Ne pas irradier directement une lumière forte telle que la lumière du soleil ou les rayons ultraviolets

CONDITIONNEMENT

carton de 100 pcs

STOCKAGE

Les gants doivent être stockés dans un environnement frais, sec et sombre sans gaz corrosifs.

Protect yourself
Protect lives



B **CONTIPHARMA**
a member of Bedelco group
COVID19

Rue de l'Environnement 22
4100 Seraing
Belgium

Mobile : +32 (0)4 330 18 60
Email : info@bedelco.com
Web : www.contipharma-covid19.com